

Canine Heartworm Antigen-Anaplasma Phagocytophylum-Platys-Borrelia Burgdorferi-Ehrlichia Canis-Ewingii Antibody Test Kit

For veterinary use only.



SNAP® 4Dx® Plus

In vitro diagnostic for the detection of *Dirofilaria immitis* antigen, antibody to *Anaplasma phagocytophylum*, antibody to *Anaplasma platys*, antibody to *Borrelia burgdorferi*, antibody to *Ehrlichia canis* and antibody to *Ehrlichia ewingii* in canine serum, plasma or whole blood.

Precautions and Warnings

- All wastes should be properly decontaminated prior to disposal.
- Do not mix components from kits with different serial numbers.
- Do not use a SNAP device that has been activated prior to the addition of sample.
- Male-only heartworm infections typically produce antigen levels that are below the detection capability of this antigen test.

Storage

- Store at 2–8°C until expiration date.
- SNAP devices and reagents can be stored at room temperature 18–25°C for 90 days or until the expiration date, whichever occurs first.
- After SNAP devices and reagents are removed from 2–8°C for more than 24 hours, the expiration date is 90 days or the printed expiration date, whichever occurs first. If the 90-day expiration date occurs prior to the printed expiration date, record the new date in the space provided on the kit.

Kit Components

Item	Reagents	Quantity
1	1 bouteille Anti- <i>D. immitis</i> / <i>Anaplasma spp./B. burgdorferi/E. canis/E. ewingii</i> : HRPO conjugate (Préservé avec gentamicin et Kathon)	7,0 mL
2	SNAP Device	5,15 ou 30
Reagents contained in each device:		
Wash Solution (preserved with Kathon)		0,4 mL
Substrate Solution		0,6 mL
Other Components:	transfert pipettes, tube à essai et réactifs	

Sample Information

- Samples must be at room temperature 18–25°C before beginning the test procedure.
- Serum, plasma or anti-coagulated whole blood (e.g., EDTA, heparin), either fresh or stored at 2–8°C for up to one week, can be used.
- For longer storage, serum or plasma can be frozen (-20°C or colder) and then reconstituted before use.
- Hemolyzed or lipemic samples will not affect test results.

Test Procedure

- If stored in a refrigerator, allow all components to equilibrate at room temperature 18–25°C for 30 minutes before use. **Do not heat.**
- Using the pipette provided, dispense **3 drops of sample** into a new sample tube.
- Holding the bottle vertical, add **4 drops of conjugate** to the sample tube.
- Cap the sample tube and mix it thoroughly by **inverting it 3–5 times**.
- Place the device on a horizontal surface. Add the entire contents of the sample tube to the sample well, being careful not to splash the contents outside of the sample well. The sample will flow across the result window, reaching the activation circle in 30–60 seconds. Some sample may remain in the sample well.
- When color **FIRST** appears in the activation circle, push the activator firmly until it is flush with the device body.

Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds, and therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

7. Read test result at **8 minutes**.

Note: The positive control may develop sooner, but results are not complete until 8 minutes.

Interpreting the Test Results

Positive Result

Any color development in the sample spots indicates the presence of *Dirofilaria immitis* antigen, *A. phagocytophylum* antibody, *A. platys* antibody, *B. burgdorferi* antibody, *E. canis* antibody or *E. ewingii* antibody in the sample.

Notes:

- The *A. phagocytophylum/A. platys* spot cannot differentiate between the two species: a positive result indicates presence of antibodies to *A. phagocytophylum* and/or *A. platys*.
- The *E. canis/E. ewingii* spot cannot differentiate between the two species: a positive result indicates presence of antibodies to *E. canis* and/or *E. ewingii*.

Negative Result

Only positive control spot develops color.



Invalid Results

Background—If the sample is allowed to flow past the activation circle, background color may result. Some background color is normal. However, if colored background obscures test result, repeat the test.

No Color Development—If the positive control does not develop color, repeat the test.

IDEXX SNAPshot Dx® Analyzer

Test results can also be read using the SNAPshot Dx® Analyzer. A complete description of how to enter patient data and read test results using the SNAPshot Dx Analyzer can be found in the SNAPshot Dx® Analyzer Operator's Guide.

Borrelia burgdorferi Vaccine Cross-Reactivity—The *Borrelia burgdorferi* assay detects antibodies induced as a result of natural infection with the organism and not following immunization with the following vaccines:

Recombitek® Lyme, LymeVax®, and Galaxy® Lyme and Nobivac® Lyme.

Recombitek is a registered trademark of Merial, Inc. LymeVax is a registered trademark of Pfizer, Inc. Galaxy and Nobivac are registered trademarks of Merck Animal Health.



Trousse de détection d'antigène de *Dirofilaria immitis* et d'anticorps contre *Anaplasma phagocytophylum-Anaplasma platys-Borrelia burgdorferi-Ehrlichia canis* et *Ehrlichia ewingii* chez le chien.
Réserve à l'usage vétérinaire.

SNAP® 4Dx® Plus

Diagnostic in vitro pour la détection d'antigènes de *Dirofilaria immitis* et d'anticorps contre *Anaplasma phagocytophylum*, *Anaplasma platys*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis* et *Ehrlichia ewingii* dans le sérum, la plasma ou le sang entier canin.

Précautions et mises en garde

- Tous les déchets doivent être décontaminés comme il se doit avant leur mise au rebut.
- Ne pas mélanger les composants des trousse comportant des numéros de série différents.
- Ne pas utiliser le dispositif SNAP s'il a été activé avant que n'y soit ajouté l'échantillon.
- Les infections dans lesquelles sont présents uniquement des vers du cœur mâles produisent généralement des taux d'antigènes inférieurs à la capacité de détection de cette analyse d'antigènes.

Conservation

- Conserver entre 2–8°C jusqu'à la date de péremption.
- Tous les dispositifs SNAP et les réactifs peuvent être conservés à la température ambiante 18–25°C pendant 90 jours ou jusqu'à la date de péremption figurant sur l'emballage, en privilégiant la première de ces deux dates.
- Dès que les dispositifs SNAP et réactifs ne sont plus maintenus à une température de 2–8°C pendant plus de 24 heures, la date de péremption est de 90 jours ou la date figurant sur l'emballage, en privilégiant la première de ces deux dates. Si la date de péremption de 90 jours survient avant la date de péremption figurant sur l'emballage, noter la nouvelle date dans l'espace prévu à cet effet sur la trousse.

Composants de la trousse


Article	Réactifs	Quantité
1	1 flacon de conjugué anti- <i>D. immitis</i> / <i>Anaplasma spp./B. burgdorferi/E. canis/E. ewingii</i> : HRPO	7,0 mL
2	SNAP Device	5,15 ou 30
Reagents contained in each device:		
Wash Solution (preserved with Kathon)		0,4 mL
Substrate Solution		0,6 mL
Other Components:	transfert pipettes, sample tubes and reagent rack	

Informations concernant les échantillons

- Les échantillons doivent être amenés à la température ambiante (18–25°C) avant d'effectuer le test.
- Il est possible d'utiliser du sérum, plasma ou sang entier anticoagulé (par ex., EDTA, héparine), frais ou conservé entre 2–8°C pendant une période d'une semaine maximum.
- Pour une durée de conservation supérieure, il est possible de congeler le sérum ou le plasma (-20°C ou en dessous) et de le centrifuger à nouveau avant l'emploi.
- Des échantillons hémolysés ou lipémiques n'affecteront pas les résultats.

Procédure du test

- S'ils ont été conservés au réfrigérateur, laisser tous les composants s'équilibrer à la température ambiante 18–25°C pendant 30 minutes. **Ne pas chauffer.**
- A l'aide de la pipette fournie, distribuer **3 gouttes d'échantillon** dans un nouveau tube.
- Tenir le flacon à la verticale et ajouter **4 gouttes de conjugué** dans le tube.
- Reboucher le tube et mélanger soigneusement avec **3 à 5 inversions**.
- Placer le dispositif sur une surface horizontale. Ajouter la totalité du contenu du tube dans le puits en évitant toute éclaboussure hors du puits. L'échantillon va s'écouler à travers la fenêtre de lecture avant d'atteindre le cercle d'activation après 30–60 secondes environ. Il est possible qu'une partie de l'échantillon reste dans le puits.
- Dès que le cercle d'activation COMMENCE à changer de couleur, enfoncez fermement l'activateur pour l'aligner sur le corps du dispositif.



Remarque: il est possible que certains échantillons n'atteignent pas le cercle d'activation en 60 secondes, auquel cas le cercle risque de ne pas changer de couleur. Si cela se produit, appuyez sur l'activateur une fois que l'échantillon a traversé la fenêtre de lecture.

- Lire les résultats du test au bout de **8 minutes**.
- Remarque: Le témoin de contrôle positif peut apparaître plus tôt mais le résultat peut seulement être considéré comme final au bout de 8 minutes.

Interprétation des résultats

Résultat positif

Tout changement de couleur dans les pastilles du prélevement révèle la présence d'antigènes *Dirofilaria immitis*, d'un anticorps contre *A. phagocytophylum*, d'un anticorps contre *A. platys*, d'un anticorps contre *B. burgdorferi*, d'un anticorps contre *E. canis* ou d'anticorps contre *E. ewingii* dans le prélevement.

Remarques:

- La pastille *A. phagocytophylum/A. platys* ne peut pas différencier entre les deux espèces: un résultat positif indique la présence d'anticorps dirigés contre *A. phagocytophylum* et/ou *A. platys*.
- La pastille *E. canis/E. ewingii* ne peut pas différencier entre les deux espèces: un résultat positif indique la présence d'anticorps contre *E. canis* et/ou *E. ewingii*.

Résultat négatif

Seule la pastille de contrôle positif change de couleur.

Résultats non valides

- Fond**—Si l'échantillon dépasse le cercle d'activation, une couleur de fond peut apparaître. Ceci est normal dans certaines limites. Toutefois, si cette couleur de fond obscurcit les résultats du test, il faut refaire le test.
- Absence de couleur**—Si le contrôle positif ne vire pas, refaire le test.

L'analyseur SNAPshot Dx® d'IDEXX*

Vous pouvez aussi lire les résultats des tests à l'aide de l'analyseur SNAPshot Dx. Le guide d'utilisation de l'analyseur SNAPshot Dx explique en détail comment entrer les données du patient et lire les résultats des tests à l'aide de l'analyseur SNAPshot Dx.

Réactivité croisée avec vaccin Borrelia burgdorferi—Le test pour *Borrelia burgdorferi* ne détecte que les anticorps produits en cas d'infection naturelle par le micro-organisme, et pas ceux produits suite à une immunisation par les vaccins suivants:

Recombitek® Lyme, LymeVax®, Galaxy® Lyme et Nobivac® Lyme.

Recombitek est une marque déposée de Merial Inc. LymeVax est une marque déposée de Pfizer Inc. Galaxy et Nobivac sont des marques déposées de Merck Animal Health.

Descriptions des symboles

Use by date	ECREP	Autorisé représentant dans la Communauté européenne
Batch Code (Lot)	LOT	Numéro de lot
Serial number	SN	Número de serie
Temperature limitation	IVD	Limite de température
Manufacturer	REF	Fabricant
Catalog Number	REF	Número de catálogo



Testkit zum Nachweis von Herzwurm (*Dirofilaria immitis*)-Antigen, *Anaplasma phagocytophylum*-Antikörpern, *Borrelia burgdorferi*-Antikörpern und *Ehrlichia canis*-/*Ehrlichia ewingii*-Antikörpern in Hunden.
Nur zum tierärztlichen Gebrauch.

SNAP® 4Dx® Plus

In-vitro-Diagnostikum zum Nachweis von *Dirofilaria immitis*-Antigen, *Anaplasma phagocytophylum*-Antikörpern, *Anaplasma platys*-Antikörpern, *Borrelia burgdorferi*-Antikörpern, *Ehrlichia canis*-Antikörpern und *Ehrlichia ewingii*-Antikörpern in Hunden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise


- Alle Abfälle müssen vor der Entsorgung ordnungsgemäß dekontaminiert werden.
- Komponenten aus Kits mit unterschiedlichen Chargenbezeichnungen nicht zusammen verwenden.
- Wenn eine SNAP Testeinheit vor Zugabe der Probe aktiviert wurde, darf sie nicht verwendet werden.
- Infektionen bei nur männlichen Herzwürmern erzeugen in der Regel Antigenspiegel, die unter der Nachweisgrenze dieses Antigen-Tests liegen.

Lagerung

- Der Test muss bei 2–8°C gelagert werden.
- SNAP Testeinheiten und Reagenzien können bei Raumtemperatur 18–25°C 90 Tage lang oder bis zum aufgedruckten Verfallsdatum gelagert werden (je nachdem, welches Datum zuerst eintritt).
- Nachdem SNAP Testeinheiten und Reagenzien länger als 24 Stunden bei einer höheren Temperatur als 2–8°C aufbewahrt werden, ist das Verfallsdatum 90 Tage oder das aufgedruckte Verfallsdatum (je nachdem, welches Datum zuerst eintritt). Wenn das Verfallsdatum von 90 Tagen vor dem aufgedruckten Verfallsdatum eintritt, das neue Datum auf dem Kit an den entsprechenden Stellen kennzeichnen.

Kitkomponenten

Artikel	Reagenzien	Menge

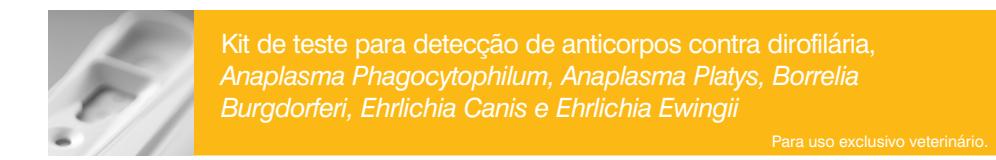

Kit de teste para detecção de anticorpos contra dirofilaria, Anaplasma Phagocytophilum, Anaplasma Platys, Borrelia Burgdorferi, Ehrlichia Canis e Ehrlichia Ewingii

Para uso exclusivo veterinário.

Versão Portuguesa

Diagnóstico in vitro para a detecção do antígeno de *Dirofilaria immitis* e dos anticorpos de *Anaplasma phagocytophilum*, *Anaplasma platys*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis* e *Ehrlichia ewingii* em soro, plasma ou sangue total canino.

Precavações e advertências

- Todos os resíduos devem ser adequadamente descontaminados antes do descarte.
- Não misture componentes de kits com números de lote diferentes.
- Não use um dispositivo SNAP que tenha sido ativado antes do acréscimo da amostra.
- A infecção por filarias do sexo masculino normalmente produz nível de antígeno que está abaixo da capacidade de detecção por este teste.

Armazenagem

- Armazene a 2-8°C.
- Os dispositivos e reagentes SNAP podem ser armazenados à temperatura ambiente 18-25°C durante 90 dias ou até a data de validade impressa, o que ocorrer primeiro.
- Depois que os dispositivos e reagentes SNAP tiverem sido retirados, **por mais de 24 horas**, do local em que estavam a temperatura de 2-8°C, a data de validade é de 90 dias ou a data impressa, o que ocorrer primeiro. Se a data de validade de 90 dias ocorrer antes da data de validade impressa, registre-a a nova data no local fornecido no kit.

Componentes do kit


Item	Reagentes	Quantidade
1	1 frasco de anti- <i>D. immitis</i> /Anaplasma spp./ <i>B. burgdorferi</i> / <i>E. canis</i> / <i>E. ewingii</i> : HRPO conjugado (Conservado com gentamicina e Kathon)	7,0 ml
2	Dispositivo SNAP	5, 15 ou 30
Reagentes contidos em cada dispositivo:		
	Solução de lavagem (Conservada com Kathon)	0,4 ml
	Solução de substrato	0,6 ml
Outros componentes: Pipetas de transferência, frascos de amostras e um suporte de reagentes		

Informações sobre a amostra

- As amostras devem estar a temperatura ambiente 18-25°C antes do inicio do procedimento de teste.
- Podem-se utilizar soro, plasma ou sangue total frescos ou armazenados a 2-8°C durante uma semana.
- Para uma armazenagem mais longa, o soro ou o plasma podem ser congelados.
- As amostras hemolisadas, ictericas ou lipêmicas não afetarão os resultados do teste.

Procedimento de teste

- Se armazenado em temperatura de refrigeração, deixe que todos os componentes se equilibrem à temperatura ambiente 18-25°C durante 30 minutos. **Não aqueça.**
- Usando a pipeta inclusa no kit, passe **3 gotas de amostra** para um tubo de amostra novo.
- Mantendo o frasco na posição vertical, acrescente **4 gotas de conjugado** ao tubo de amostra.
- Tampe o tubo de amostra e misture-o bem ao invertê-lo **de 3 a 5 vezes**.
- Coloque o dispositivo sobre uma superfície horizontal. Acrescente todo o conteúdo do tubo de amostra ao orifício de amostra, com cuidado para não deixar que respingue fora.
- A amostra fluirá pela janela de resultado, alcançando o círculo de ativação em aproximadamente 30 a 60 segundos. Pode ser que reste um pouco de amostra no orifício de amostra.
- ASSIM** que a cor aparecer no círculo de ativação, empurre firmemente o ativador até que esteja nivelado com o corpo do dispositivo.



Observação: algumas amostras podem não fluir para o círculo de ativação dentro de 60 segundos e, portanto, o círculo pode não mudar de cor. Neste caso, abra o ativador depois que a amostra tiver fluido pela janela de resultado.

7. Leia o resultado do teste em **8 minutos**.

Observação: O controle positivo pode se desenvolver mais rapidamente, mas os resultados não estão completos até 8 minutos.

Interpretação dos resultados

Resultado positivo

Qualquer surgiamento de cor nos poços de amostra indica a presença do antígeno de *Dirofilaria immitis*, do antícorpo de *A. phagocytophilum*, do antícorpo de *A. platys*, do antícorpo de *B. burgdorferi*, do antícorpo de *E. canis* e do antícorpo de *E. ewingii* na amostra.

Observações:

- O teste de ponto para *A. phagocytophilum*/*A. platys* não é capaz de diferenciar entre estas duas espécies, e um resultado positivo indica a presença de anticorpos contra *A. phagocytophilum* e/ou *A. platys*.
- O teste de ponto para *E. canis*/*E. ewingii* não é capaz de diferenciar entre estas duas espécies, e um resultado positivo indica a presença de anticorpos contra *E. canis* e/ou *E. ewingii*.

Resultado negativo

A cor só surge no ponto de controle positivo.



Resultados inválidos

- Fundo**—Se permitir que a amostra flua além do círculo de ativação, pode surgir cor no fundo. Um pouco de cor no fundo é normal. Porém, se o fundo colorido obscurecer o resultado do teste, repita o teste.
- Não surge cor**—Se o controle positivo não acarretar no surgimento de cor, repita o teste.

Analizador IDEXX SNAPshot Dx*

Os resultados dos testes também podem ser lidos com o SNAPshot Dx. Existe uma descrição completa acerca do modo de introdução dos dados dos pacientes e de como ler os resultados com o SNAPshot Dx no guia do utilizador SNAPshot Dx.

Reatividade cruzada da vacina da Borrelia burgdorferi—O teste para *Borrelia burgdorferi* detecta anticorpos induzidos em consequência de infecção natural com o microorganismo e não após vacinação com as seguintes vacinas:

Recombitek® Lyme, LymeVax®, e Galaxy® Lyme e Nobivac® Lyme.

Recombitek é uma marca registrada de Merial, Inc. LymeVax é uma marca registrada de Pfizer, Inc. Galaxy e Nobivac são marcas registradas de Merck Animal Health.



Kit per il test dell'antigene della *Dirofilaria immitis* degli anticorpi di *Anaplasma phagocytophilum*/*Anaplasma platys*/*Borrelia burgdorferi*/*Ehrlichia canis*/*Ehrlichia ewingii* nel cane

Esclusivamente per uso veterinario

SNAP® 4Dx® Plus

Dispositivo de diagnóstico in vitro para o rastreamento do antígeno da *Dirofilaria immitis* e dos anticorpos de *Anaplasma phagocytophilum*, *Anaplasma platys*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis* e *Ehrlichia ewingii* em soro, plasma ou sangue total canino.

Precavações e advertências

- Todos os resíduos devem ser adequadamente descontaminados antes do descarte.
- Não misture componentes de kits com números de lote diferentes.
- Não use um dispositivo SNAP que tenha sido ativado antes do acréscimo da amostra.
- A infecção por filarias do sexo masculino normalmente produz nível de antígeno que está abaixo da capacidade de detecção por este teste.

Conservação

- Conservar a temperatura compresa entre 2-8°C.
- I dispositivi SNAP e i reagenti possono essere conservati a temperatura ambiente 18-25°C per 90 giorni o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
- Se i dispositivi SNAP e i reagenti non sono tenuti a temperatura compresa tra 2-8°C per un periodo di tempo superiore a 24 ore, possono essere conservati per 90 giorni o fino alla data di scadenza, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Se la data di durata di 90 giorni è anteriore alla data di scadenza, annotare la nuova data nell'apposito spazio presente sul kit.

Componentes del kit

Artículo	Reagente	Quantidade
1	1 frasco de conjugado anti- <i>D. immitis</i> /Anaplasma spp./ <i>B. burgdorferi</i> / <i>E. canis</i> / <i>E. ewingii</i> : HRPO conjugado (Geconserveerd met gentamicine en Kathon)	7,0 ml
2	Dispositivo SNAP	5, 15 ou 30
Reagentes contidos em cada dispositivo:		
	Solução de lavagem (Conservada com Kathon)	0,4 ml
	Solução de substrato	0,6 ml
Outros componentes: Pipetas de transferência, frascos de amostras e um suporte de reagentes		

Informações sobre a amostra

- As amostras devem estar a temperatura ambiente 18-25°C antes do inicio do procedimento de teste.
- Podem-se utilizar soro, plasma ou sangue total frescos ou armazenados a 2-8°C durante uma semana.
- Para uma armazenagem mais longa, o soro ou o plasma podem ser congelados.
- As amostras hemolisadas, ictericas ou lipêmicas não afetarão os resultados do teste.

Procedimento de teste

- Se conservado em refrigeração, deixe que todos os componentes se equilibrem à temperatura ambiente 18-25°C durante 30 minutos. **Não aqueça.**
- Serviendosi della pipetta, inserire **3 gocce di campione** in una provetta nuova.
- Tenendo il fracone in posizione verticale, aggiungere **4 gocce di conjugato** nella provetta.
- Mettere il tappo sulla provetta e mescolare accuratamente **capovolgendo** da **3 a 5 volte**.
- Collocare il dispositivo su una superficie piana. Trasferire tutto il contenuto della provetta nel pozzetto del campione, prestando attenzione a non far schizzare il contenuto fuori del pozzetto. Il campone fluisce attraverso la finestra dei risultati, raggiungendo il cerchio di attivazione in circa 30-60 secondi. Parte del campone potrebbe rimanere nel pozzetto del campione.
- APPENA il colore compare nel cerchio di attivazione, premere l'attivatore con fermezza fino a quando non si trova a filo con il corpo del dispositivo.



Importante: alcuni campioni potrebbero non fluire nel cerchio di attivazione entro 60 secondi, di conseguenza il cerchio potrebbe non cambiare colore. In questo caso, premere l'attivatore dopo che il campione è passato attraverso la finestra dei risultati.

7. Leggere il risultato del test trascorsi **8 minuti**.

Nota: il punto del controllo positivo potrebbe svilupparsi prima, ciononostante l'esito dell'esame non è da considerarsi definitivo prima che siano trascorsi 8 minuti.

Interpretação dos resultados

Risultati positivi

Lo sviluppo di colore nei punti campione indica la presenza di antigeni *Dirofilaria immitis*, anticorpi di *A. phagocytophilum*, anticorpi di *A. platys*, anticorpi di *B. burgdorferi*, anticorpi di *E. canis* e anticorpo di *E. ewingii* nel campione.

Risultati negativi

Solo la macchia del controllo positivo sviluppa il colore.

Risultati non validi

- Stando**—Se si lascia fluire il campione oltre il cerchio di attivazione, lo sfondo può sviluppare colore. Uno sviluppo di colore sullo sfondo in quantità ridotta è normale. Tuttavia, se il colore dello sfondo impedisce di leggere i risultati, ripetere il test.
- Nessuno sviluppo di colore**—Se il controllo positivo non sviluppa colore, ripetere il test.

Analizzatore IDEXX SNAPshot Dx*

I resultados dos testes podem ser lidos com o SNAPshot Dx. Existe uma descrição completa acerca do modo de introdução dos dados dos pacientes e de como ler os resultados com o SNAPshot Dx no guia do utilizador SNAPshot Dx.

Reatividade cruzada da vacina da Borrelia burgdorferi—O teste para *Borrelia burgdorferi* detecta anticorpos induzidos em consequência de infecção natural com o microorganismo e não após vacinação com as seguintes vacinas:

Recombitek® Lyme, LymeVax®, e Galaxy® Lyme e Nobivac® Lyme.

Recombitek é uma marca registrada de Merial, Inc. LymeVax é uma marca registrada de Pfizer, Inc. Galaxy e Nobivac são marcas registradas de Merck Animal Health.

Descrição dei simboli

	Usare entro		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Codice del lotto (partita)		ECREP
	Numero de serie		Consultare le istruzioni per l'uso
	Limite de temperatura		IVD
	Ditta produttrice		Data di produzione
	Número de catálogo		REF

Supórté tecnico IDEXX
EUA/Canadá 1 800 248 2483 • Europa 00800 1234 3399
Austrália 1300 44 33 99
idexx.com

PRODUTO IMPORTADO Proprietário e Fabricante: IDEXX Laboratories Inc. One IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, USA

Rua: 10000-00000-0000 - CEP: 06094-010

CNPJ N° 47.334.7